TRUSTED BY MIDWIVES

GB/IE

Milton

BABY EXPERT SINCE 1916

COMBI

Steriliser
Microwave or Cold Water

THANK YOU FOR CHOOSING MILTON!

Fits most size bottles and microwaves.

IMPORTANT INSTRUCTIONS, PLEASE READ

Congratulations on choosing your new Milton Combi Steriliser with unique safety vent technology for better, faster steam sterilisation. Before using it for the first time, please read this leaflet carefully and keep it safe for future reference.

If you do mislay the leaflet, don't worry, you can download a copy at:

miltonbaby.co.uk • miltonbaby.ie

YOUR FIRST COMBI USE

Before you first use your new Milton Combi, familiarise yourself with its layout and parts. Then wash all the Combi parts in warm soapy water and rinse in cold water.

ANY QUESTIONS?
Visit www.milton-tm.com

Trademark owned by Milton International.
Product colours/design may vary.

Recycle

YOUR MILTON COMBI PARTS GUIDE

A Pop-up safety vent
B Screw lid with submerger and seal
C Handle
D Base
E Fill line (5L) for cold water sterilisation

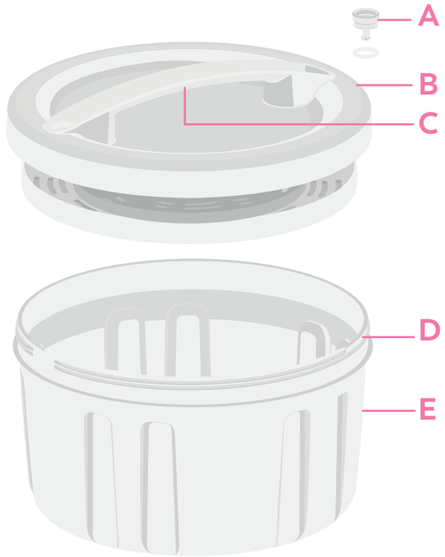

HOW TO GET THE BEST USE FROM YOUR MILTON COMBI:

• The individual parts of the Milton Combi can be cleaned in the dishwasher.
• To remove the submerger from the lid for cleaning, insert fingers into the holes as shown and twist anti-clockwise.
• Reverse the procedure to re-attach to the lid.
• It is only necessary to use the submerger when using the cold water sterilising method, although for convenience it can still be left attached to the lid when sterilising in a microwave.

2 ways to sterilise choose the most convenient for you!

1. The Cold Water Method: Instructions for use

1 CLEAN
Clean bottles, teats and accessories thoroughly with warm soapy water, using Milton Baby Bottle Cleaner. Remove any milk residue. Rinse with cold water.

2 PREPARE THE MILTON SOLUTION
Fill your Milton Combi with cold water to the 5L mark. Add 1 Standard Milton Sterilising Tablet or 30ml of Milton Sterilising Fluid. Follow the instructions on the Fluid & Tablets labels carefully.

3 ADD ITEMS TO THE SOLUTION
Wash your hands. Fully submerge items in the solution to remove any trapped air bubbles. When you screw on the Combi lid the integral submerger will then ensure that all items are kept in the solution. Screw on lid. Press the vent down if it is raised. Everything is sterilised in 15 minutes. Remove items and rinse them with water before use. Follow the instructions on the Sterilising Fluid or Tablets labels carefully. Renew the solution every 24 hours.

IMPORTANT: Your Milton Combi is specially designed for use solely with Milton Sterilising Tablets or Fluid. Other sizes or makes of tablet/fluid could damage your Milton Combi and affect its performance.

DID YOU KNOW?

The bottle can be left in the sterilising solution until you need to use it. When you have a used bottle simply clean it and immerse it in the solution. You can continue to add and remove bottles to the same solution for 24 hours.

WARNINGS WHEN USING THE COLD WATER METHOD:

• This product may break if dropped when full of water.
• Do not transport a Combi full of water or solution as it could leak through the valve.
• Always carry your Combi upright.
• Dry your Milton Combi well after each use to prevent a build-up of limescale.
• For optimum effectiveness, descale once a month.

ASK THE EXPERTS:

• WHY SHOULD I STERILISE?
During your baby's first 12 months, their immune system is still developing. This means that your baby is more likely to catch germs than an older child or an adult. This can result in nasty infections such as tummy upsets, gastroenteritis and oral thrush. You need to make sure all feeding equipment is clean and properly sterilised.

• WHAT SHOULD I STERILISE?
Sterilise anything that goes into baby's mouth:
• Baby bottles and teats
• Soothers and teething rings
• Breast feeding utensils and milk storage containers
• Small plastic toys and weaning items

• DID YOU KNOW?
56% of baby bottles are contaminated by bacteria like *E.coli.** This is why it's important to clean and sterilise all feeding and breastfeeding equipment carefully, until your baby's immune system is fully developed.

For more information, visit our website at:
miltonbaby.co.uk • miltonbaby.ie

*Mason P, Jenkins G, Burdon M (2024) Sterilisation of Infant Feeding Bottles: Focus on the Cold-Water Method Using. Chlorine Containing Compounds. J Community Med Public Health 8: 429.

2. The Microwave Method: Instructions for use

1 CLEAN
Clean bottles, teats and accessories thoroughly with warm soapy water, using Milton Baby Bottle Cleaner. Remove any milk residue. Rinse with cold water.

2 FILL
Pour 200ml of water in your Milton Combi base. Then load items upside down. IMPORTANT: Your Milton Combi will not sterilise properly unless the correct amount of water is added. You can use a baby bottle to measure exactly 200ml of water.

3 LOAD AND CLOSE
Load bottles with the opening **face down**. Screw on the lid. Press the safety vent down if raised. When steam pressure builds up inside Combi the safety vent will pop out automatically.

4 MICROWAVE
2 mins at 1100-1850W
4 mins at 850-1000W
6 mins at 500-800W

5 COOL AND USE
For safer handling, leave the Milton Combi to cool inside the microwave for at least 3 minutes after the microwave cycle has finished. Remove the Milton Combi using oven gloves to prevent scalding. Wash your hands well before handling sterilised items. Unscrew the lid and take the contents out using tongs. If you don't want to use your bottles straight away after microwaving, press the pop-up safety vent back down to keep the bottles inside the Milton Combi sterile for longer.

DID YOU KNOW?

If the Milton Combi is left unopened after microwaving and the safety vent is closed, the bottle will remain sterile in the Milton Combi for up to 24 hours.

WARNINGS FOR USE IN THE MICROWAVE:

• Check the power of your microwave before you begin using it.
• Check that the accessories you want to sterilise can be microwaved.
• Always keep the microwave turntable clean and dry before use. For smaller microwaves, the turntable may need to be removed to allow the Milton Combi to fit in.
• Always use the right quantity of water and follow the heating and timings instructions carefully.
• Always ensure that your Milton Combi is clean with no old water residue before use in the microwave.
• The Milton Combi contains boiling water when being sterilised. Handle with care and keep out of the reach of children.
• Always wait 3 minutes before removing the Milton Combi from the microwave to let it cool down. Ensure that you take care, as it will contain hot water and steam. Always place it on a hard, heat-resistant surface.
• Do not put Milton Sterilising Tablets or Fluid inside the Milton Combi when you place it inside your microwave.
• Do not use metallic items in your Milton Combi as this could damage your microwave.
• Dry your Combi well after each use to prevent a build-up of limescale.

THIS PRODUCT MAY BREAK IF DROPPED WHEN FULL OF WATER.

Look out for our other Milton products

STERILISING RANGE

Solo Travel Steriliser
• 2 in 1 : gives you the choice of 2 Sterilising Methods
• Unique safety vent technology for better steam sterilisation
• Ideal size when travelling; holds 1 bottle

Mini Soother Steriliser
• Sterilises any soother when you're out and about
• Can easily be attached to your buggy or pram
• Designed to be used with Milton Mini Sterilising Tablets, killing 99.9% of germs

Cold Water Unit
• Big capacity: holds 6 bottles
• Sterilises in 15 min with Milton Sterilising Tablets or Fluid
• Used & Trusted by midwives and professionals in hospitals

Sterilising Fluid & Tablets
• Sterilises in 15 min
• Multi-purpose : can be used for baby accessories or general cleaning
• Used and Trusted by midwives and parents for over 75 years

PLANT-BASED HYGIENE RANGE

Baby Bottle Cleaner
• Developed to clean all baby feeding equipment
• Tested to remove milk residue responsible for the growth of bacteria
• Clinically tested for sensitive skin
• Easy to rinse

Antibacterial Surface Spray
• 2 in 1: Cleans & disinfects all surfaces
• 100% plant-based active ingredient derived from corn/beetroot.
• Ideal for highchairs, fridges, work tops, tables, changing mats, etc.
• Mint fragrance

Antibacterial Hand Sanitiser
• For babies from 3 months old, children, adults
• Alcohol-free, fragrance-free
• Plant-based moisturising formula
• Tested for sensitive skin

Antibacterial Hand Gel
• Kills 99.9% of germs (bacteria & viruses) within seconds
• Ideal when travelling, in public facilities, before or after feeding or changing your baby
• 100% Plant-based alcohol derived from beetroot
• Kids from 3 years old & adults

Antibacterial Surface Wipes
• Disinfect quickly all baby accessories with no need to rinse
• Ideal for soothers, teats, toys
• Alcohol derived from beetroot

USE BIOCIDES SAFELY.
Always read the label and product information before use.

EXPERT BÉBÉ
depuis 1916

FR

Milton

Recommandé par les sages-femmes

COMBI

Stérilisateur
Micro-ondes ou à froid

MERCI D'AVOIR CHOISI MILTON !

Compatible avec la plupart des biberons et des micro-ondes.

CONSIGNES IMPORTANTES À LIRE ATTENTIVEMENT

Nous vous remercions d'avoir choisi le stérilisateur Milton Combi doté d'une valve de sécurité unique, pour une stérilisation à la vapeur rapide et efficace. Avant la première utilisation, prenez le temps de bien lire cette notice. Veuillez ensuite la conserver à portée de main, car elle contient des informations importantes qui pourraient s'avérer utiles ultérieurement.

milton-solutions.fr

VOTRE PREMIÈRE UTILISATION DU COMBI

Avant d'utiliser votre nouveau stérilisateur Milton Combi, familiarisez-vous avec sa présentation. Ensuite lavez toutes les parties du Combi avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle, puis rincez à l'eau froide.

DES QUESTIONS ?
Consultez le site www.milton-solutions.fr
Marques de fabrique détenues par Milton International.
Les modèles/couleurs du produit peuvent varier.

PRESENTATION DES PIÈCES

A Valve de sécurité
B Couvercle vissable avec grille d'immersion et joint
C Poignée
D Base
E Ligne de remplissage (5L) pour la méthode de stérilisation à froid

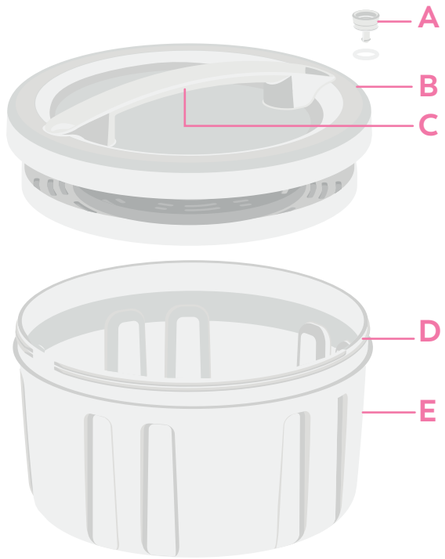

COMMENT UTILISER AU MIEUX VOTRE STÉRILISATEUR COMBI :

• Chaque pièce du stérilisateur Milton Combi peut être nettoyée au lave-vaisselle.
• Pour séparer la grille du couvercle afin de la nettoyer, insérez vos doigts dans les orifices prévus à cet effet (voir illustration) puis tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Suivez la procédure inverse afin de refixer la grille au couvercle.
• La grille sert uniquement lorsque vous utilisez le mode de stérilisation à froid. Il peut toutefois rester fixé au couvercle lors de la stérilisation au micro-ondes, pour des raisons de commodité.

2 méthodes de stérilisation possibles À vous de choisir votre préférée.

1. La stérilisation à froid : mode d'emploi

1 NETTOYER
Nettoyer soigneusement les biberons, tétines et accessoires avec de l'eau chaude et le Nettoyant biberons et vaisselle Milton. Retirer les résidus de lait. Rincer à l'eau froide.

2 PRÉPARER LA SOLUTION MILTON
Remplir le stérilisateur Combi d'eau froide jusqu'à la ligne 5 litres. Ajouter 1 comprimé de stérilisation Milton.

3 PLONGER LES ACCESSOIRES DANS LA SOLUTION
Se laver les mains. Immerger entièrement les accessoires dans la solution en veillant bien à éliminer toutes les bulles d'air. Lorsque le couvercle du stérilisateur est vissé, la grille permet aux accessoires de rester immergés dans la solution. Visser le couvercle. Enfoncer la valve de sécurité si elle est relevée. Les accessoires sont stérilisés en 15 minutes. Retirer les accessoires et les rincer à l'eau claire avant utilisation. La solution doit être renouvelée toutes les 24 heures.

IMPORTANT : votre stérilisateur Milton est conçu pour être utilisé exclusivement avec des comprimés de stérilisation Milton. Si vous utilisez d'autres comprimés de tailles différentes, vous risquez d'endommager votre stérilisateur Milton Combi, ce qui compromettra son efficacité.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Avec la stérilisation à froid, les accessoires peuvent être laissés dans la solution jusqu'à ce que vous en ayez besoin et resteront stériles dans la solution pendant 24 heures. Des accessoires peuvent être ajoutés et retirés d'une même solution pendant toute une journée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI POUR LA MÉTHODE À FROID :
• Ce produit peut se casser s'il tombe quand il est rempli d'eau.
• Ne transportez pas le Combi plein d'eau ou de solution car elle pourrait s'écouler à travers la valve. Transportez toujours votre Combi debout.
• Séchez bien votre Combi après chaque utilisation afin d'éviter l'accumulation de calcaire.

VOS QUESTIONS SUR LA STÉRILISATION :

• **POURQUOI DOIS-JE STÉRILISER ?**
Pendant les 12 premiers mois, le système immunitaire de votre bébé est encore en phase de développement, il a donc besoin d'une protection supplémentaire contre les germes qui peuvent être à l'origine de gastro-entérites et d'infections.
Pour cela, vous devez vous assurer que tout l'équipement servant à son alimentation est propre et correctement stérilisé.

• **QUE DOIS-JE STÉRILISER ?**
Essentiellement, tout ce qui peut aller dans la bouche de votre bébé !
Cela inclut les biberons, les sucettes, les cuillères en plastique, les bols, les anneaux de dentition et les jouets. Il en est de même pour vos accessoires d'allaitement, les éléments du tire-lait et les récipients servant à conserver le lait.

• **LE SAVIEZ-VOUS ?**
56% des biberons sont contaminés par *E.coli*.* C'est pour cela qu'il est nécessaire de nettoyer et stériliser tous les accessoires d'allaitement avec précaution, jusqu'à ce que le système immunitaire de bébé soit entièrement développé.

Pour plus d'informations, visitez notre site web : milton-solutions.fr

•Mason P, Jenkins G, Burdon M (2024) Sterilisation of Infant Feeding Bottles: Focus on the Cold-Water Method Using. Chlorine Containing Compounds. J Community Med Public Health 8: 429.

2. La stérilisation au micro-ondes : mode d'emploi

1 NETTOYER
Laver toutes les parties du biberon avec de l'eau chaude et le Nettoyant biberons et vaisselle Milton, puis rincer à l'eau froide.

2 REMPLIR
Verser précisément 200 ml d'eau dans le Combi. IMPORTANT : votre Combi ne pourra pas fonctionner correctement tant que la bonne quantité d'eau n'aura pas été ajoutée. Vous pouvez utiliser un biberon pour mesurer la quantité d'eau exacte (200 ml).

3 AJOUTER PUIS FERMER
Ajouter les biberons en positionnant bien **l'ouverture vers le bas**. Visser le couvercle. Enfoncer la valve de sécurité si elle est relevée. Lorqu'assez de vapeur est générée, la valve se soulève automatiquement.

4 MICRO-ONDES
Passer au micro-ondes pendant :
2 min à 1100-1850W
4 min à 850-1000W
6 min à 500-800W

5 REFROIDIR ET UTILISER
Par précaution, laisser le stérilisateur Milton Combi refroidir dans le micro-ondes pendant au moins 3 minutes après la fin du cycle. Retirer le stérilisateur Milton Combi avec des gants de cuisine pour ne pas se brûler. Bien se laver les mains avant de manipuler les accessoires stérilisés. Dévisser le couvercle puis retirer le contenu à l'aide de pinces. Si vous ne souhaitez pas utiliser les biberons tout de suite après leur passage au micro-ondes, enfoncez à nouveau la valve de sécurité et les biberons resteront stériles plus longtemps.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Si le stérilisateur Milton Combi reste fermé après son passage au micro-ondes et que la valve de sécurite est enfoncée, les accessoires demeureront stériles pendant 24 heures maximum.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI POUR L'USAGE AU MICRO-ONDES :
• Vérifiez la puissance de votre micro-ondes avant de l'utiliser.
• Vérifiez que les accessoires à stériliser soient compatibles au micro-ondes.
• La plaque tournante du micro-ondes doit toujours être propre et sèche avant toute utilisation. Pour les micro-ondes de petite taille, vous devrez peut-être retirer la plaque tournante pour y introduire le stérilisateur Combi.
• Veillez toujours à ce que votre stérilisateur Combi soit propre, exempt de résidus d'eau, avant toute utilisation dans le micro-ondes.
• Veuillez utiliser l'exacte quantité d'eau demandée pour éviter la distorsion du plastique.
• Veuillez respecter le temps d'utilisation indiqué selon la puissance du micro-ondes.
• Le stérilisateur Milton Combi contient de l'eau bouillante lors de son utilisation. Veuillez le manipuler avec précaution et le tenir hors de portée des enfants.
• Veuillez toujours attendre 3 minutes avant de retirer le stérilisateur Combi du micro-ondes pour qu'il ait le temps de refroidir. Soyez toujours très vigilant(e) car le stérilisateur contient de l'eau et de la vapeur chaudes. Veillez à toujours le poser sur une surface dure et résistante à la chaleur.
• N'introduisez pas de comprimé de stérilisation Milton dans le stérilisateur Combi lorsque vous le placez dans le micro-ondes.
• N'introduisez pas d'accessoires métalliques dans votre stérilisateur Combi car ils pourraient endommager votre micro-ondes.
• Séchez bien votre Combi après chaque utilisation afin d'éviter l'accumulation de calcaire.

CE PRODUIT PEUT SE CASSER S'IL TOMBE REMPLI D'EAU.

Découvrez tous les produits Milton !

GAMME STÉRILISATION

Solo Stérilisateur de voyage :
• 2 en 1 : donne le choix entre 2 méthodes de stérilisation
• Valve de sécurité unique pour une stérilisation à la vapeur efficace
• Peut contenir 1 biberon et s'adapte à tous les micro-ondes

Mini Stérilisateur de sucettes
• Stérilise les sucettes pendant vos balades et déplacements
• Peut facilement être attaché à la poussette ou au sac
• À utiliser avec les Mini comprimés de stérilisation qui éliminent 99.9% des germes

Bac de stérilisation
• Grande capacité : peut contenir 6 biberons
• Stérilise en 15 min grâce aux Comprimés de stérilisation
• Utilisé par les professionnels de la petite enfance

Comprimés de stérilisation
• Stérilise à froid en 15 min par trempage les accessoires bébé
• Multi-usages : désinfecte les sols et surfaces
• Utilisé et reconnu par les professionnels de santé

GAMME HYGIÈNE

Nettoyant biberons et vaisselle
• Formulé pour nettoyer efficacement tous les accessoires bébé
• Testé pour éliminer les résidus de lait propices au développement des bactéries
• Testé cliniquement pour les peaux sensibles
• Se rince facilement.

Gel mains désinfectant
• Élimine 99.9% des germes en quelques secondes
• Idéal en voyage, dans les transports en commun, avant ou après le repas ou le change de bébé
• Alcool 100% d'origine végétale issu de betterave
• Enfants dès 3 ans et adultes

Mousse mains désinfectante
• Adapté aux bébés dès 3 mois, enfants, adultes
• Sans alcool, sans parfum
• Formule hydratante testée pour les peaux sensibles

Nettoyant désinfectant multi-surfaces
• 2 en 1: Nettoie et désinfecte toutes les surfaces
• Actif 100% d'origine végétale issu de la betterave ou du maïs.
• Idéal pour les chaises hautes, plans de travail, tables, matelas de change, etc.
• Parfum menthe

Lingettes désinfectantes de surfaces
• Désinfectent rapidement et sans rinçage tous les accessoires de bébé
• Idéales pour les sucettes, tétines, jouets
• Alcool issu de la betterave

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRECAUTION.
Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.